


REPROCESAMIENTO DE COLONOSCOPIOS OLYMPUS
Serie 185L, 190L, 260L, 290L, 1100L, 1200L, 1500 L (Versión larga)

PROTOCOLO REFORZADO*

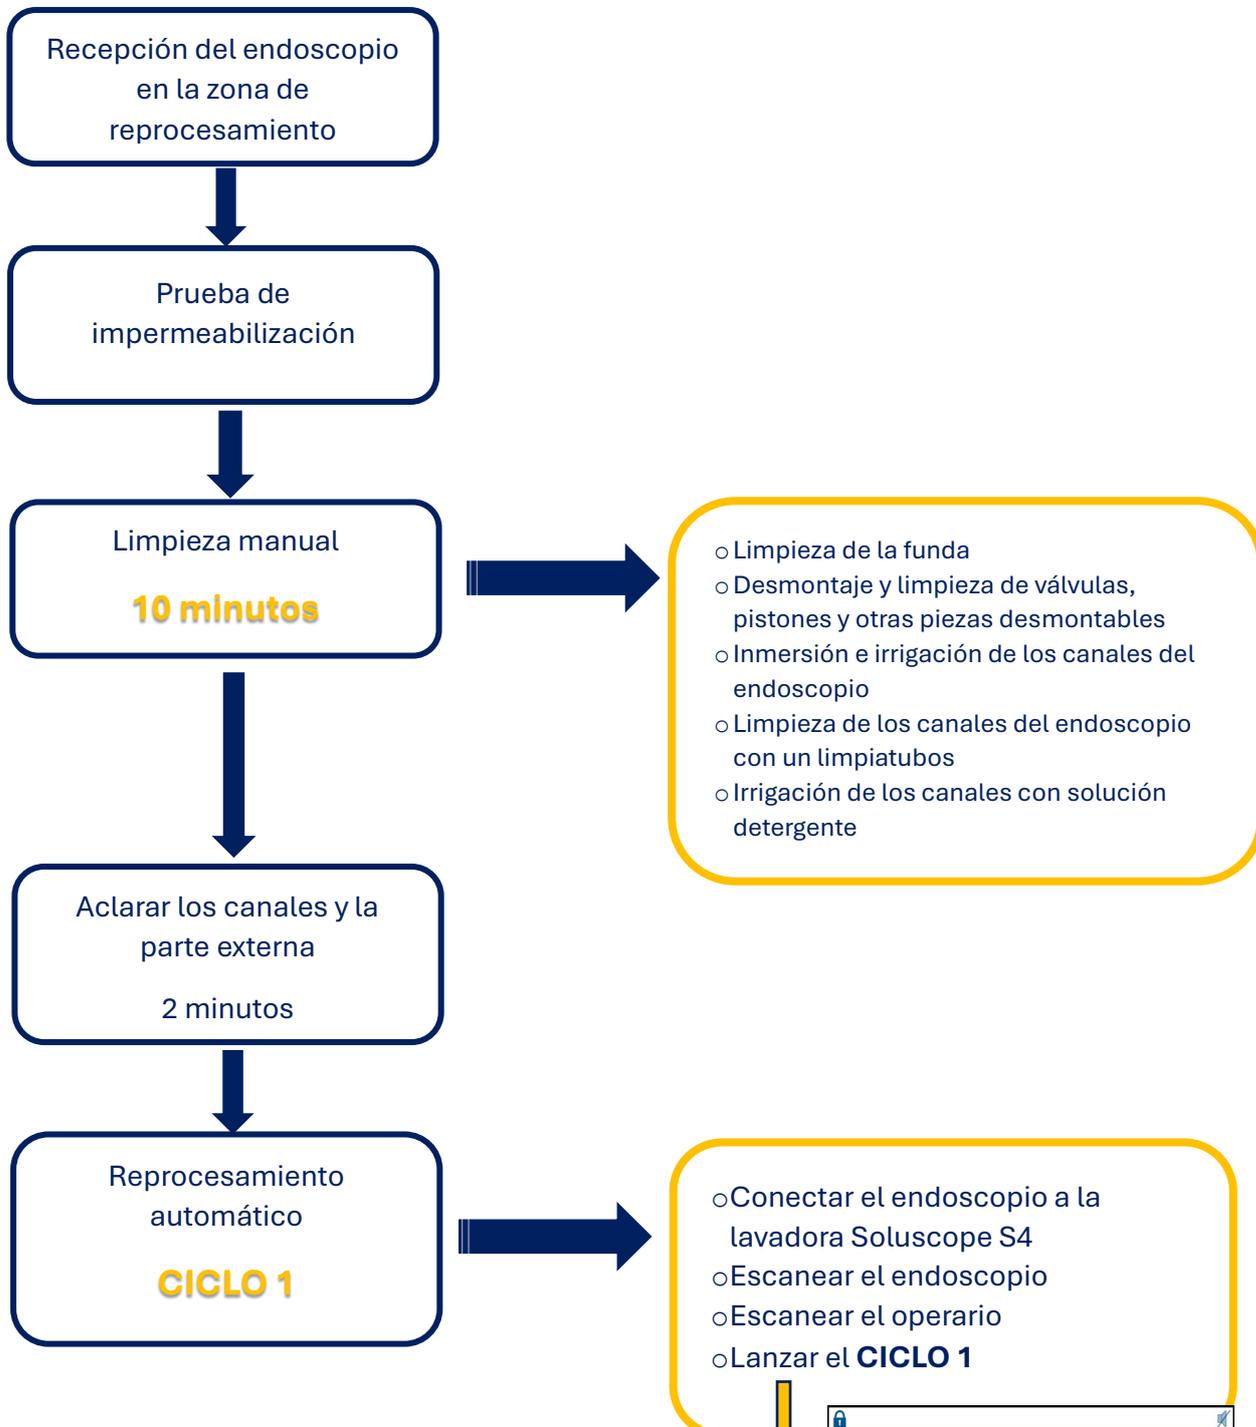

**Implantar un protocolo reforzado que sustituya el ciclo 2 para reprocesar los colonoscopios Olympus Series 185L, 190L, 260L, 290L, 1100L, 1200L, 1500L (versión larga)*